

H.U.D.N	
Correspondencia Despachada	
Vigencia: 2021 - Consecutivo: D-2308	
Consecutivo: D-2308	
Fecha de Radicación:	01/07/2021-02:20 PM
Asunto:	SR JOSE BUESAQUILLO: RESPUESTA OBSERVACIONES PRESE.
Firmado por:	particular-GESTION DE L
Destinatarios:	METROMED SAS-
Externos:	(PASTO)
Radicator:	NANCY ROMERO

San Juan de Pasto, 01 de Julio de 2021

Señor:
JOSÉ RAPHAEL BUESAQUILLO Z.
Representante legal
METROMED SAS
Cel: 3166808372

Ref. Respuesta observaciones presentadas respecto a la Solicitud Simple de Ofertas 013-S.S.O. 2021, cuyo objeto es: "Contratar la prestación del servicio de calibración y validación de equipos biomédico e industriales de propiedad del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E."

Cordial saludo,

Prevía verificación de la correspondencia de la entidad y el email institucional asignado para el presente proceso y teniendo en cuenta las inquietudes formuladas a la Solicitud Simple de Ofertas de la referencia, el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E responde.



OBSERVACION No. 1: En relación "EQUIPO REQUERIDO" se solicita revisar los equipos mínimos solicitados teniendo en cuenta que para los casos de calibración acreditada se acepta establecer convenios cuyos equipos no serán necesarios para temas de calibración por trazabilidad como es el caso de la balanza analítica y el equipo de Termohigrometría los cuales no serían necesarios para calibraciones por trazabilidad de igualmente se solicita aclarar que los rangos de calibración acreditada son rangos mínimos de acuerdo a las necesidades del cliente y no a rangos de trabajo de los equipos patrón ya que estos limitan a marcas específicas en dichos patrones.


Respuesta entidad componente técnico: Se acepta la observación. Teniendo en cuenta que las variables Temperatura, humedad y masa solicitadas por el hospital deben cumplir con métodos acreditados bajo la norma 17025 para los cuales el proponente deberá anexar certificado de acreditación del método, ya sea propio o bajo la modalidad de convenio ante el organismo nacional de acreditación ONAC o por un organismo de acreditación que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA). Se publicará adenda

Fol: 2


Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Commutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co * mail: hudn@hosdenar.gov.co

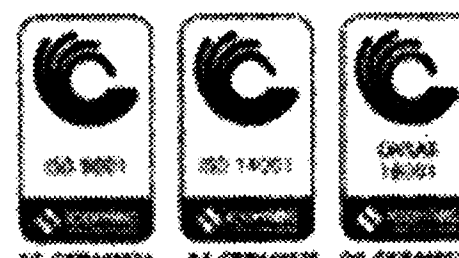

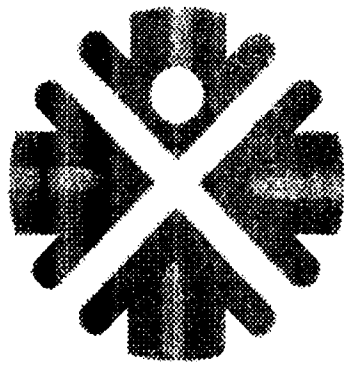

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

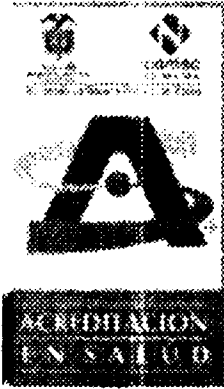




eliminando los patrones de termohigrometria y balanza analítica del listado de equipos con trazabilidad.

En relación a los rangos de calibración se aclara que estos hacen relación a las necesidades de los servicios sin embargo, no limita a la utilización de un determinado patrón, estos rangos serán revisados en el alcance de los certificados aportados por los proponentes. Por tanto se acepta la observación.

Atentamente

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
Gerente

Reviso Componente técnico: Lynn Melodelgado- Profesional Universitario Mantenimiento 
Proyecto Componente técnico: Flor Ángela Riascos Capera - Técnico Operativo de Mantenimiento 
Proyecto Componente técnico: Gregory Legarda - Ingeniero Electrónico Contratista 

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co / mail: hudn@hosdenar.gov.co

