

EVALUACIÓN TÉCNICA

| | |
|-------------|-------------------------|
| CÓDIGO: | FECHA DE ELABORACIÓN: |
| VERSIÓN: | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |
| HOJA 1 DE 1 | |



28 de Noviembre de 2022
SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. 023-S.O.2022

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE DOS MESAS DE CIRUGÍA ELECTROHIDRAULICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN EL AREA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E

| REQUISITO | CONCEPTO | OBSERVACIONES | CONCEPTO | OBSERVACIONES | CONCEPTO | OBSERVACIONES |
|--|----------|--|----------|---------------|-----------|--|
| Radio transmicida en toda su extensión, elevador de rídon en material radiolucido integrado | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |
| Sección de cabeza y pluma ajustables manualmente | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |
| Las secciones desmontables para las plumas soportadas con amortiguadores de gas o neumáticos. 4 Ruedas que permitan un sistema de bloqueo al piso manual | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | NO CUMPLE | No adjunta ficha técnica, se evidencia " CERTIFICACION ", la entidad requiere ficha técnica. |
| Sistema integrado de nivelación automática en 1 solo paso. | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |
| Túnel para casete de rayos x de 14" integrado debajo de la mesa. | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | NO CUMPLE | No adjunta ficha técnica, se evidencia " CERTIFICACION ", la entidad requiere ficha técnica. |
| Base y columna en acero inoxidable de fácil limpieza. | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |
| Colchoneta antestática para manejo de presión en material resistente y de fácil limpieza. | CUMPLE | Subsana adjuntando especificaciones del tipo de material de las colchonetas. | CUMPLE | Ninguna | NO CUMPLE | No adjunta ficha técnica, se evidencia " CERTIFICACION ", la entidad requiere ficha técnica. |
| Control de mando manual alámbrico y panel de mando auxiliar de emergencia en la base de la mesa. | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |

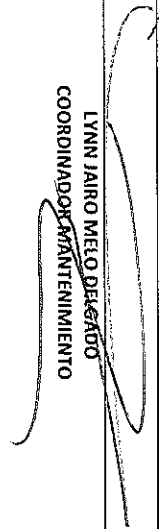
COMPRE DEL CONTRATANTE: BARCO NIT. 860.044.349-4 INCLUSER NIT. 900.180.069-3 ELECTROMÉDICA NIT. 90058549-6

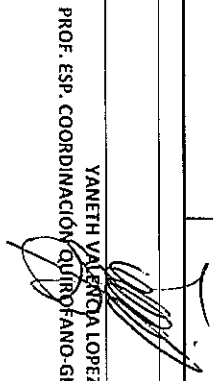
INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| Operación con batería recargable integrada de 1 semana aproximadamente 10 ~ 20 ciclos de funcionamiento o 100 accionamientos | NO CUMPLE | Se evidencia en ficha técnica "80 actos quirúrgicos" en la operabilidad de la batería, no se aclaró a cuantos ciclos o tiempo de operación de batería | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |
| Capacidad de carga máxima igual o superior a 270 kg. | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |
| Accesorios mínimos requeridos: - 2 Soportes para brazos con clamps de sujeción ajustables en 180° horizontalmente, incluye correa de sujeción en velcro, almohadilla de espuma | NO CUMPLE | No subsana, adjunta ficha técnica pero no describe medidas. | NO CUMPLE | No subsana, puesto que adjunta ficha técnica de soporte de brazo sin traducción al castellano, incluyendo lo descrito en el pliego de condiciones NUMERAL 22.1 Item B. Y la CIRCULAR EXTERNA UNICA expedida por Colombia compra eficiente Numeral 8.4. | NO CUMPLE | No subsana, puesto que adjunta ficha técnica de soporte de brazo sin traducción al castellano, incluyendo lo descrito en el pliego de condiciones NUMERAL 22.1 Item B. Y la CIRCULAR EXTERNA UNICA expedida por Colombia compra eficiente Numeral 8.4. | NO CUMPLE | No adjunta ficha técnica, se evidencia " CERTIFICACION ", la entidad requiere ficha técnica. |
| 1 marco de anestesia con clamps de sujeción | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |
| 1 correa de sujeción para cuerpo. | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |
| Dimensiones: 520mm de ancho x 2082mm de largo. Altura mínima: 700-1040mm, con una tolerancia +/- 10% de las dimensiones | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |
| Desplazamiento longitudinal total mínimo de 350mm con una tolerancia +/- 10%. | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |
| Trendelenburg/trendelenburg inversa: 30° / 30° Con una tolerancia 15° | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |
| Intervalo de inclinación lateral: 0-20° o mayor | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |
| Sección de espalda +80°/-30° 15° | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna |

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|--|-----------|--|--|
| Movimiento de la cabeza: +40° a +60° / -90° o mayor | CUMPLE | Ninguna | NO CUMPLE | No subsana, puesto que adjunta ficha técnica de soporte de brazo sin traducción al castellano, incumpliendo lo descrito en el pliego de condiciones NUMERAL 22.1 ítem B, y la CIRCULAR EXTERNA ÚNICA expedida por Colombia compra eficiente Numeral 8.4. | CUMPLE | Ninguna | No adjunta ficha técnica, se evidencia " CERTIFICACION ", la entidad requiere ficha técnica. |
| Movimiento de las piernas: +30°/-90° "Giro de 90° hacia el exterior de cada pierna, total 180° las dos piezas" | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | De acuerdo con el concepto técnico biomédico, cumple con las especificaciones requeridas por la entidad. | NO CUMPLE | No cumple con especificaciones técnicas requeridas. | Ninguna |
| Elevador de riñón radio lúcido 12cm x1 cm o mayor. | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | CUMPLE | Ninguna | Ninguna |
| ACCESORIO PARA CIRUGIA DE HOMBRO, se posiciona en la sección de asiento de las mesas una vez se eliminan la sección de piernas, colocar al paciente mediante el resorte de gas de apoyo. Apoya cabeza de varios ejes, permite una fácil colocación de la cabeza. Paneles de hombro desprendibles proporcionan acceso quirúrgico excelente para cada hombro. Incluye correas de sujeción de cabeza | NO CUMPLE | No subsana, no se anexa ficha técnica. | CUMPLE | Item se encuentra en documento anexo "posicionador de hombro" | NO CUMPLE | No adjunta ficha técnica, se evidencia " CERTIFICACION ", la entidad requiere ficha técnica. | |
| SOPORTE PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA, diámetro ajustable según las necesidades quirúrgicas. Un conjunto de tres piezas incluye colchonetas. | NO CUMPLE | No subsana, no se anexa ficha técnica. | CUMPLE | Ninguna | NO CUMPLE | No adjunta ficha técnica, se evidencia " CERTIFICACION ", la entidad requiere ficha técnica. | |
| PAR SOPORTE LATERAL, Montado sobre rieles laterales para apoyar el cuerpo del paciente en posición lateral. Almohadilla: con unas medidas aproximadas opcionales de 4 cm de ancho, 15,5cm de alto x 24,5 cm LARGO. Ajustable en altura de 0 a 15 cm o mayor COMPATIBLE CON MESA DE CIRUGIA. | NO CUMPLE | No subsana, no se anexa ficha técnica. | CUMPLE | Ninguna | NO CUMPLE | No adjunta ficha técnica, se evidencia " CERTIFICACION ", la entidad requiere ficha técnica. | |

| | | | | | | |
|---|------------------|--|---------------|----------------|------------------|---|
| <p>PAR CLAMP DE FIJACION PARA RIEL, en acero inoxidable, ideal para accesorios con barras planas en cualquier lugar a lo largo de carril lateral de la mesa; bloqueo simultáneo del accesorio y del damp al carril lateral.</p> | <p>NO CUMPLE</p> | <p>No subsana , no se anexa ficha técnica.</p> | <p>CUMPLE</p> | <p>Ninguna</p> | <p>NO CUMPLE</p> | <p>No adjunta ficha técnica, se evidencia " CERTIFICACION ", la entidad requiere ficha técnica.</p> |
|---|------------------|--|---------------|----------------|------------------|---|


LYNN JAIRO MELO DEGADO
 COORDINADOR MANTENIMIENTO


YANETH VALENCIA LOPEZ
 PROF. ESP. COORDINACIÓN QUÍMICO-ORGÁNICO-GINECOOBSTETRICIA